

Ein portables Flüssigsauerstoffgerät muss nun nicht mehr im Bett gelagert werden, sondern wird einfach außerhalb des Betts eingehängt!



- Maximale Patientensicherheit
- Leicht desinfizierbar
- Gewicht 1,25 kg
- Medizinprodukt Kl. 2b
- Konformitätserklärung
- Gurtsicherung für das LOX-Gerät

# LOX-Tragesystem - BESTELLSCHEIN

Sie können uns diese Bestellung per E-MAIL unter [info@criticalcare.de](mailto:info@criticalcare.de) oder per FAX übermitteln: 04191 - 95 88 92. Es gelten die AGB der Critical care Gesellschaft für home care Medizintechnik GmbH, einsehbar unter: <https://www.criticalcare.de/shop/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html>.

Hiermit bestelle ich  Stck. LOX-Tragesystem(e).

Firma:

Mein Vorname:

Mein Nachname:

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

Straße:

Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Ggf. abweichende Lieferadresse:

Straße:



Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Datum

Unterschrift:



WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEWÄSSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHÄFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:			ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		
NAME:			ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		
SIGNATUR:			OBERFLÄCHENGÜTE: <b>Pulverbeschichtet RAL 9002 Grobstruktur</b>		
DATUM:			BENENNUNG:		
GEZEICHNET:			WERKSTOFF: <b>ALU</b>		
GEPÜFT:			ZEICHNUNGSNR.: <b>Halterung_8.1</b>		
GENEHMIGT:			MASSSTAB: 2:1		
PRODUKTION:			BLATT 1 VON 1		
QUALITÄT:			A4		

---

# EG-Konformitätserklärung

## EC Declaration of Conformity

---



DEHAS Medical Systems GmbH | Wesloer Str. 107-109 | 23568 Lübeck, Germany

**Produkt/  
Medical device:** **MH Tragesystem für Portables Sauerstoffsystem**  
*Zubehör für Easy Mate/ Accessories for Easy Mate series*

**Artikelnummern/  
Item numbers:** D-LOX-PortiSAFE

**Klassifikation/  
Classification:** **IIb**  
Regel 11, Anhang IX, Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG  
*Rule 11, Annex IX of Medical Device Directive 93/42/EEC*

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt mit den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang 1 der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG übereinstimmt. Alle Belegdokumente werden in den Räumlichkeiten des Herstellers und der benannten Stelle aufbewahrt.

*We hereby declare under our sole responsibility that the above product is in conformity with the basic requirements according to Annex 1 of the Medical Device Directive 93/42/EEC. All supporting documents are kept on the premises of the manufacturer and the notified authority.*

**Konformitätsbewertungsverfahren/  
Conformity assessment route:** Anhang II (ohne Abschnitt 4) der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG (Vollständiges Qualitätssicherungssystem)  
*Annex II (without section 4), Medical Device Directive 93/42/EEC (Full quality assurance system)*

**Angewandte Normen/  
Applied standards:**

EN ISO 14971	ASTM D4169-16
EN 1251-1	EN 1251-3
EN 1251-2	

**Benannte Stelle/ Notified Body:** DNV Medcert GmbH, Pilatuspool 2, 20355 Hamburg, Germany


**Kenn-Nummer/ ID number:**  0482

**EG Zertifikats-Nr./ EC Certificate no.:** 4153GB410200327

**Ausstellungsdatum/ Date of issue:** 2020-03-27

**Ablaufdatum/ Expiry date:** 2024-05-27

Lübeck, 2023/09/12

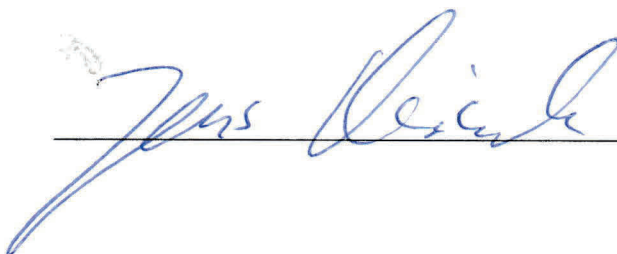

---

Das Produkt D-LOX-PortiSAFE wurde als Zubehör der EasyMate Familie für die folgende Produktserie mit folgenden Artikeln entwickelt:

*The D-LOX-PortiSAFE product was developed as an accessory of the EasyMate family for the following product series with the following items:*

<b>Artikelnummer / Product code</b>	<b>Produktbezeichnung/ Device name</b>
D-PM2110	EasyMate 6 Portable LOX-System, continuous flow, 11 settings with 0.25- 6l/min
D-PM2120	EasyMate 6+6 Portable LOX-System, continuous flow 6 settings from 1-6 l/min and pulse flow 5 settings with 2-6 l/min equivalents
D-PM2125	EasyMate 12 Portable High-Flow LOX-System, 0-12 l/min continuous flow
D-PM2200CE	EasyMate Portable LOX-System, Tyco fill connector, universal, top fill, 0-4 l/min pulse flow
D-PM2202CE	EasyMate Portable LOX-System, Chart fill connector, side fill
D-PM2203CE	EasyMate Portable LOX-System, Taema fill connector, top fill

DEHAS bestätigt, dass das Gerät auch für andere flüssig Sauerstoff transportable Geräte, wie die HELIOS™ Plus & Marathon Serie; Spirit® Serie; Sprint™ / Stroller® / Hi Flow Stroller® Serie verwendet werden kann.

*DEHAS confirms that the device can also be used for other liquid oxygen transportable devices, such as the HELIOS™ Plus & Marathon Series; Spirit® Series; Sprint™ / Stroller® / Hi Flow Stroller® Series.*